


蛍光分光強度測定プログラム

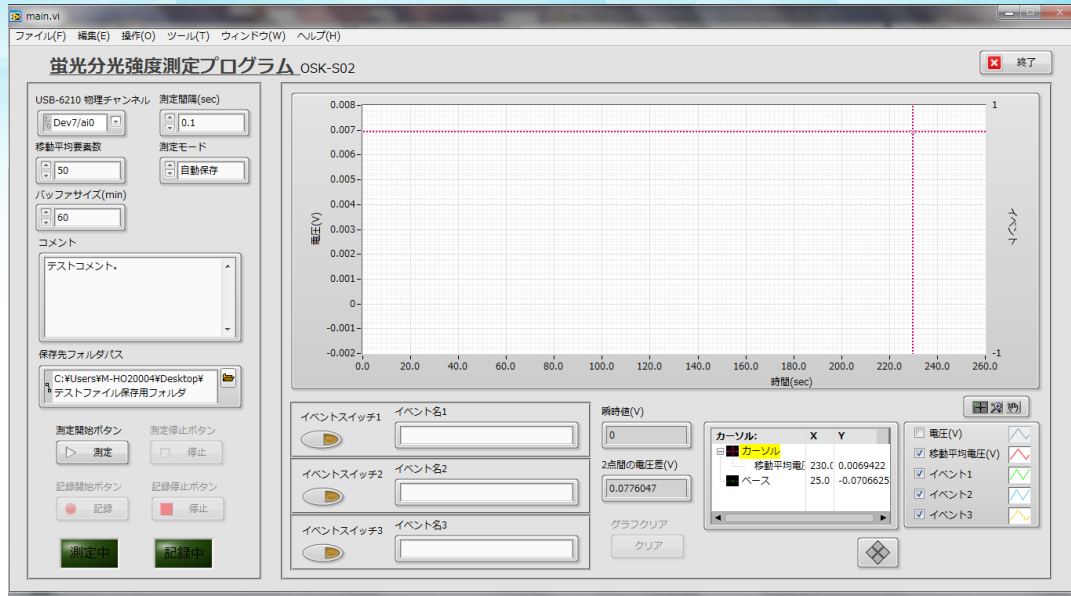

➤ 装置概要

1. 「蛍光分光強度測定プログラム OSK-S02」は、蛍光分光強度の測定において必要なパラメータの設定と、測定および記録を簡単に行えるプログラムです。

➤ 仕様

項目	仕様	
対応OS	MS-Windows® Windows 7、Windows XP	
動作環境	プロセッサ：Intel Pentium III 650 MHzあるいはこれと同等のもの 空きディスク容量：4GB以上 / システムメモリ (RAM)：512MB以上	
対応DAQ(A/D変換)	NATIONAL INSTRUMENTS® NI USB 6210	
主な機能	測定 (1ch) / データ保存 (CSV形式) / グラフ表示・保存	
供給媒体	CD-ROM	
設定項目	サンプリング周期	0.1秒 ~ 100秒
	移動平均要素数	1 ~ 256個
	イベント項目	(イベントスイッチ、イベントテキスト)× 3件

※商品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。